


CAPTEUR SPO2 NEONATE Y POUR SPENGLER MASTER PALM 2



Ref. 222252

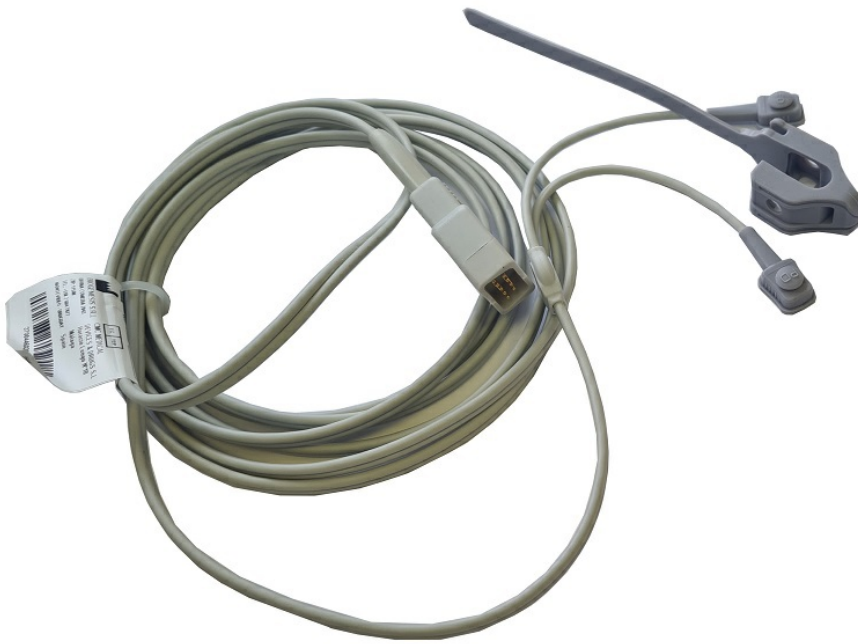

CE
0537

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIb
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
1
YEAR
GUARANTEE



30/08/2024 16:45:30 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

CAPTEUR SPO2 NEONATE Y POUR SPENGLER MASTER PALM 2



Ref. 22252

Description

Capteur SpO2 neonate y pour oxymetre MASTER PALM 2

Caracteristiques

Marquage CE	CE0537	Dispositif Medical	Classe IIb
Code barre	3700446030223	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	12	Pays	Uruguay
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.086
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	1	Temperature maxi	50
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 16:45:30 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr